

СП60, ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Серия: Аппаратура Вибробит 100

Приспособление СП60 предназначено для калибровки и опробования датчиков наклона поверхности.


Первоначальное горизонтальное положение приспособления СП60 устанавливается с помощью уровня брускового 200–0,02 ГОСТ 9392–89 в двух, перпендикулярных друг к другу направлениях.

Задание наклона контрольной поверхности СП60 производится по часовому индикатору регулировочным винтом. Величина смещения часового индикатора ИЧ10 кл.0 ГОСТ 577–68 от нулевого уровня при наклоне поверхности на 1 мм/м равна 0,25 мм.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон смещения наклона поверхности, мм/м	± 20
Основная абсолютная погрешность установки наклона поверхности, мм/м	$\pm 0,06$
Коэффициент перерасчета	4
Габаритный размер, мм	324×162×198
Масса, кг, не более	12

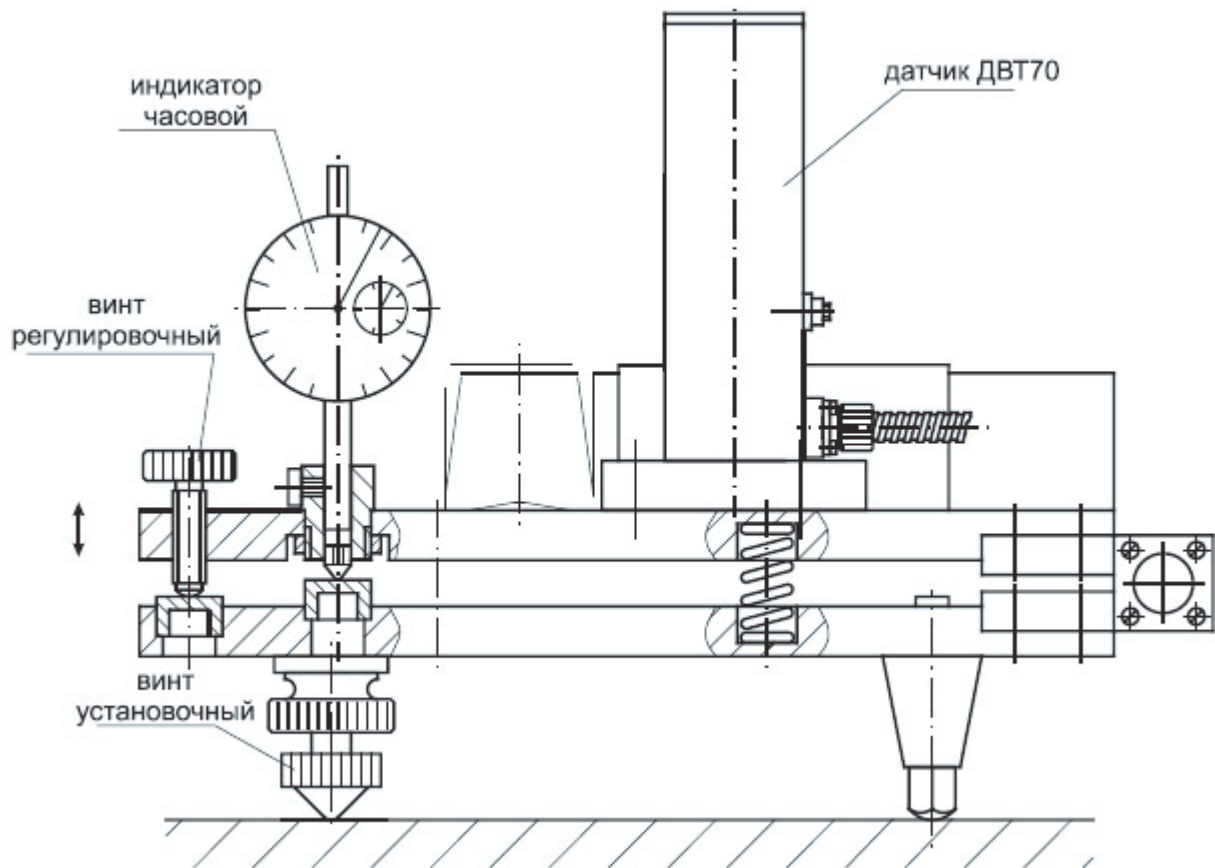

ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка и опробование измерителя наклона поверхности совместно с датчиками:

Датчик [ДВТ70](#) с преобразователем измерительным [ИП44](#)

Датчик [S170с](#)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение при заказе: Приспособление СП60 ВШПА.421412.056

ЗАГРУЗКИ

[ВШПА.421412.056 ПС Приспособление СП60. Паспорт \[03\].](#)

[ВШПА.421412.156 МП Аппаратура «Вибробит 100» \(датчик ДВТ70\) методика поверки](#)

[ТУ 4277-001-27172678-10 Аппаратура «Вибробит 100». Технические условия](#)

[ТУ 4277-001-27172678-12 Аппаратура «Вибробит 100». Технические условия](#)

[ВШПА.421412.410.490 РЭ. Датчик уклона S170. Руководство по эксплуатации](#)

